




## TD2 型水银真空表

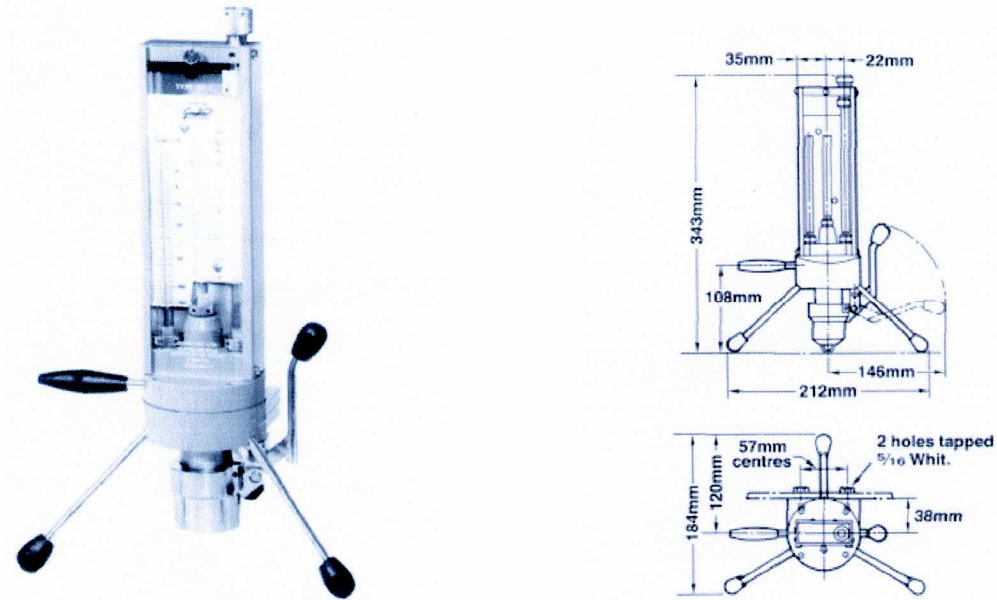

TD2 型水银真空表用于准确测定真空度，测量范围为 0-15 torr 或 0-200 mbar (绝对压力)。

测量精度依靠两根毛细管达到，毛细管的刻度如下：

第一种刻度：150±2 torr      (200±2 mbar)

第二种刻度：2±1×10<sup>-3</sup> torr      (2.6±2×10<sup>-3</sup> mbar)

因维护和使用较很方便，本仪器适用于任何应用场合。